

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 26.05.2020 r.

ZP/ 26 /2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pytanie dotyczy załącznika nr 3- Pakietu nr 36 pkt 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy dodatkowy port do sprawdzania poprawności działania przetwornika opisany w punkcie 5 ma być portem typu „plug in”, który polega na wprowadzeniu drenu wysokociśnieniowego do specjalnie dedykowanego otworu zwanego portem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza port typu „plug in”.

Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 2

Pytanie dotyczy załącznika nr 3- Pakietu nr 36 pkt 8:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przetwornika, o łącznej długości drenu do pacjenta 150 cm, w tym: 120 cm + 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie przetwornika, o łącznej długości drenu do pacjenta 150 cm, w tym: 120 cm + 30 cm. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian

Pytanie 3

Pytanie dot. pakietu nr 17:

Czy Zamawiający dopuści balon lekowy z syrolimusem gdzie dawka leku zamiast 3ug/m2 wynosi 1,27ug/m2, jest to udokumentowana dawka leku gdzie 84% pozostaje w zmianie przy minimalnej utracie leku tranzytowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie balonu lekowego pokrytego syrolimusem z dawką leku 1,27ug/m2. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 13


Czy zamawiający dopuszcza cewniki balonowe o profilu końcówki max 0.017”, średnicach od 1,2 do 5mm i spełniające pozostałe wymagania techniczne?



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



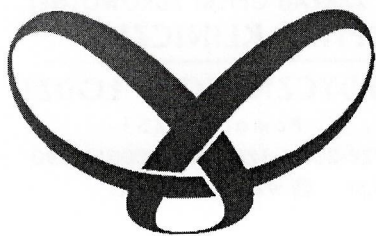

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy też o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie profilu szafu i, zamiast "profil shaftu, max. 0,78F' dla średnic do 2,5 mm", nie powinno być „profil shaftu, max. 0,78 mm dla średnic do 2,5 mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe o profilu końcówki max 0.017", średnicach od 1,2 do 5mm. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian. Sprostowanie brzmienia pkt 2 – treść powinna brzmieć : profil shaftu, max. 0,78mm dla średnic do 2,5 mm. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 15

Czy zamawiający dopuszcza cewniki balonowe o poniższych parametrach:

- profil max 0.017",
 - minimalnie wymagane nominalne średnice od 1,20 mm do 4,00 mm,
 - przedział długości: od 6 mm do 30 mm; dla długości 25 i 30mm brak średnic 1,20 oraz 1,50mm,
- i spełniające pozostałe wymagania techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający także dopuszcza cewniki balonowe o proponowanych w pytaniu 5 parametrach. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 25

Czy zamawiający dopuszcza stenty o minimalnym wymaganym przedziale średnic nominalnych: od 2,00 do 4,0 mm i spełniające pozostałe wymagania techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga średnic minimalnie do 4,5mm lub stentów o średnicy min. 4.0mm z możliwością doprężenia do 4,5mm Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 28

Czy zamawiający dopuszcza stentgrafty o zakresie średnic od 2,8 do 4,8mm oraz o profilu przejścia 0.059", i spełniające pozostałe wymagania techniczne?

Odpowiedź: Tak, zamawiający także dopuszcza stentgrafty o opisanych w pytaniu parametrach. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 54

Czy zamawiający dopuszcza cewniki balonowe o minimalnym wymaganym przedziale długości od 6.0 do 30.0 mm – dostępnym w całym przedziale średnic od 2 do 4mm. Dla średnic 4.5 i 5.0 mm dostępne długości 12 i 15 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga średnic minimalnie do 5mm.

Pytanie 9



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



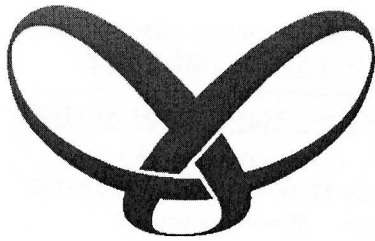

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakietu 38

Czy Zamawiający dopuści łącznik wysokociśnieniowy o długości 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min długości 200mm.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 55

Czy Zamawiający dopuści wkład strzykawkowy do podawania kontrastu o pojemności 150 ml, kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Mark V Provis?

Odpowiedź: Zamawiający może dopuścić opisywany w pytaniu wkład pod warunkiem dostarczenia próbki w celu sprawdzenia kompatybilności z posiadanym we wstrzykiwaczu uchwytem na wkłady. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian

Pytanie 11

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczące-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow>), Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie takie, również niezależnie od ilości ofert złożonych w postępowaniu, potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. **Wobec powyższe Zamawiający dopuszcza taką możliwość, z tym zastrzeżeniem, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.**

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 „Cewnik balonowy uwalniający lek do restenozy w stencie” – wyrazi zgodę na ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuści także cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym 6atm i RBP 14atm. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



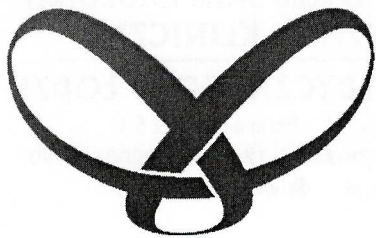

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 „Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus” dopuści Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną – Sirolimus

1. substancja czynna: sirolimus ($1.2 \mu\text{g}/\text{mm}^2$)
2. pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej
3. brak powłoki polimerowej
4. platforma: stent kobaltowo-chromowy
5. zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm
6. zakres długości: 9 – 38 mm
7. długość systemu doprowadzającego: 145 cm
8. grubość ściany stentu 0,0020” dla średnic 2,0 – 2,5 mm oraz 0,0024” dla wszystkich pozostałych rozmiarów
9. shaft proksymalny 1,9F
10. shaft dystalny 2,5F
11. profil wejścia 0,016 ”
12. ciśnienie RBP 18 atm. - dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm
13. ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także stentów o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 „Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek bez polimeru „ dopuści Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną – Sirolimus

1. substancja czynna: sirolimus ($1.2 \mu\text{g}/\text{mm}^2$)
2. pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej
3. brak powłoki polimerowej
4. platforma: stent kobaltowo-chromowy
5. zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm
6. zakres długości: 9 – 38 mm
7. długość systemu doprowadzającego: 145 cm
8. grubość ściany stentu 0,0020” dla średnic 2,0 – 2,5 mm oraz 0,0024” dla wszystkich pozostałych rozmiarów
9. shaft proksymalny 1,9F, shaft dystalny 2,5F
10. profil wejścia 0,016 ”
11. ciśnienie RBP 18 atm. - dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm
12. ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga stentów o opisanych w SIWZ parametrach.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 24


Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 „ Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus lub biolimus”



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



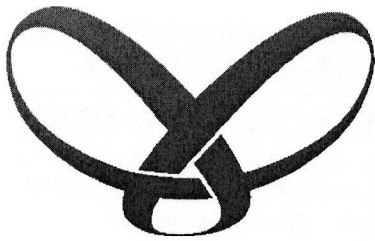

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

dopuszczenia Stent uwalniającej substancję antyproliferacyjną – Sirolimus

1. substancja czynna: sirolimus (1.2 µg/mm²)
2. pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej
3. brak powłoki polimerowej
4. platforma: stent kobaltowo-chromowy
5. zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm
6. zakres długości: 9 – 38 mm
7. długość systemu doprowadzającego: 145 cm
8. grubość ściany stentu 0,0020” dla średnic 2,0 – 2,5 mm oraz 0,0024” dla wszystkich pozostałych rozmiarów
9. shaft proksymalny 1,9F
10. shaft dystalny 2,5F
11. profil wejścia 0,016 ”
12. ciśnienie RBP 18 atm. - dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm
13. ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także stentów o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający w pakiecie nr 36” Kopyłki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą” dopuszczenia przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, kompatybilny z posiadanymi przez Szpital monitorami.

1. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h
2. Częstotliwość własna przetwornika 200Hz
3. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne
4. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek
5. Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) **bez dodatkowych portów do kalibracji**
6. Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 1 x linia płuczająca, 1x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty dł. 125 cm średnica światła 1.5 x 2.7 mm ,
7. dwudzielna komora kropłowa z filtrem z membraną 15µm zapobiegającym przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także kopyłek o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 57


Czy Zamawiający dopuszczenia dedykowane do zmian zwapnionych wysokociśnieniowe cewniki balonowe do przezskórnej walwuloplastyki (PTV) o średnicy 5 – 30 mm, długości 20mm, 30mm, 40mm i 60mm, znamionowym ciśnieniu rozrywającym RBP 4 – 15 atm i kompatybilne z przewodnikiem 0,035 cala dla średnic 8 – 30 mm i z przewodnikiem 0,025 cala dla średnic 5 – 7 mm?



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



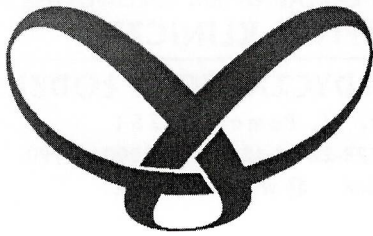

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Oferowany cewnik balonowy (szczególnie wysokociśnieniowym dzięki wzmocnionemu odcinkowi z balonem) charakteryzuje się:

- Atraumatyczną końcówką
- Krótkie czasy inflacji i deflacji
- Złote znaczniki kontrastujące w promieniach RTG
- Szeroki zakres rozmiarów w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności

i wskazany jest do stosowania:

- Predylatacja zastawki aortalnej podczas TAVI
- Zwężenie cieśni aorty
- Zwężenie drogi odpływu prawej i lewej komory
- Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej
- Zwężenie zastawki aortalnej
- Obwodowe zwężenie tętnicy płucnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także balonów o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do zmian prostych o profilu wejścia 0,017"? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także cewników balonowych o opisanych w pytaniu parametrach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia składu komisowego w zadaniu 30 w zamian za dostawę sukcesywną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga utworzenia składu komisowego (o ile pytanie dotyczy Pakietu 28 – w Pakiecie 30 nie ma komis).

Dotyczy Pakietów 20 i 25

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 20** stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus o nieznacznie zmienionych parametrach: stenty bez pokrycia pasywnego o ciśnieniu nominalnym dla stentu o średnicy 3,0 mm 10 atm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także stentów o opisanych w pytaniu parametrach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



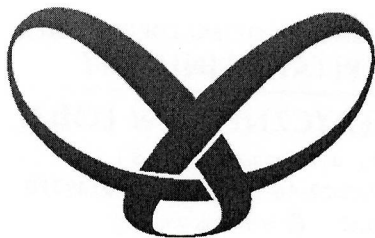

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 25** stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o nieznacznie zmienionych parametrach: typ uwalnianego leku: Sirolimus oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby typem uwalnianego leku był everolimus.

Pytanie 22

Dotyczy zapisów SWIZ – pakiet nr 33

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w ilości 2 szt. dla pakietu nr 33 tj. kleszczyki do usuwania ciał obcych.

Pytanie 23

Dotyczy przedmiotu zamówienia, zapisów SIWZ – pakiet nr 34

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 34 pętli do usuwania ciał obcych wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego owiniętego cienkim, cieniodajnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze od 5 mm do 30 mm.

2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w ilości 2 szt. dla pakietu nr 34 tj. pętli do usuwania ciał obcych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także pętli o opisanych w pytaniu parametrach. Pozostałe parametry, w tym konieczność utworzenia depozytu zgodne, z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 58

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 58 przewodników typu Amplatz extra sztywnych o dostępnych długościach 145, 180, 260, 300 cm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wykreślenie opisu z wymaganych parametrów w pkt. 3 dotyczącego cewnika z pakietu nr 58. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także przewodników o opisanych w pytaniu parametrach. Zamawiający zgadza się na wykreślenie z SIWZ z Pakietu nr 58 pkt nr 3.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik 7 do siwz.


1. Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §2 ust. 1 o zwrot: „Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.”



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



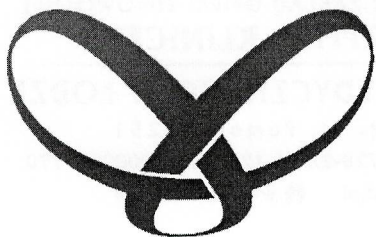

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

2. Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §2 ust. 4: „Powierzony towar musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą oraz uszkodzeniem zgodnie z przyjętymi zasadami u Zamawiającego, na jego koszt. Za wyrób uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).”

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści Cewniki wieńcowe diagnostyczne o średnicy wewnętrznej min. 0,041'' dla 4F? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w każdym punkcie Pakietu nr 4 w SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 26

Czy Zamawiającemu chodziło o cewnik aspiracyjny wyposażony w strzykawkę 2x 30ml lub 1x 60ml? A jeśli nie to czy dopuści cewnik aspiracyjny wyposażony w strzykawkę 2x 30ml? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania sprzęt wyposażony w strzykawkę o pojemności 30 lub 60ml i dopuszcza do postępowania cewnik aspiracyjny wyposażony w strzykawkę 2x 30ml? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 28

Pytanie dot. Wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad jakościowych wynosił 14 dni?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie zestawu transradialnego o następujących parametrach:

- koszulka wykonana z ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) dostępna w długościach 7 i 10cm
- zestaw dostępny z koszulką o powłoce hydrofilnej (dla rozmiarów 5 i 6 FR) o długościach 10, 16 i 25cm?
- z przewodnikiem stalowym o prostej końcówce?



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



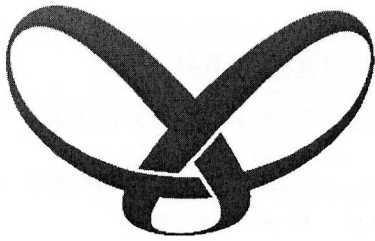

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 19 stentu kobaltowo chromowego uwalniającego Sirolimus o następujących parametrach:

- grubość ściany stentu 0,00315" dla wszystkich rozmiarów
- występujący w średnicach 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 oraz długościach 9,12,15,18,24,28,33,38 mm
- możliwość post dylatacji dla rozmiarów 3.5-4.0mm do 5.8mm ?
- minimalny czas DAPT wynosi 1 miesiąc i jest potwierdzony w IFU?

Reszta parametrów SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także przewodników o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego nie uwalniającego leku o ciśnieniu nominalnym (NP) 6 atm oraz maksymalnym (RBP) 14 atm ?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie cewnika balonowego nie uwalniającego leku. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Pytanie 32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 50 wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrocewnika do CTO o następujących parametrach:

- taperowany shaft o zewnętrznej średnicy: proksymalnie 1.8Fr, dystalnie 2.6Fr, wewnętrznej średnicy: proksymalnie 0,021", dystalnie 0,018"
- dostępne długości 130 i 150cm ?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także mikrocewników o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 33, dot. Zad. 2

Czy Zamawiający dopuści przewodniki diagnostyczne o długościach 150, 175, 180, 220, 260 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania także przewodników o opisanych w pytaniu parametrach. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34, dot. Zad. 13

Czy w określeniu parametrów w zad 13, w punkcie 7 nie doszło do pomyłki liczbowej w określeniu max profilu shaftu cewnika balonowego?


Odpowiedź: W Pakiecie 13 nie ma punktu 7, natomiast w opisie w pkt 2 powinna znaleźć się treść: „profil shaftu, max. 0,78mm dla średnic do 2,5 mm” Doszło do pomyłki w opisie max profilu shaftu jednostkami powinny być mm a nie F (French).



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



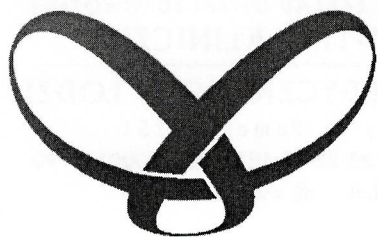

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie nr 35, dot. Zad. 14

Czy Zamawiający dopuści japońskie cewniki balonowe gdzie cewniki NC oferujemy w zakresie długości 1.5-4.5mm?

Odpowiedź: Minimalny wymagany przedział długości to 6 do 30mm, Natomiast w Pakiecie 14 w pkt 7 opisane są średnice wymagane tj 1,5 do 4.0 w wersji S.C. (semicompliant) oraz 2.0 do 5.0 w wersji NC.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w pak 9 wyrazi zgodę w poz. 10 w parametrach ocenianych na umieszczenie zapisu: dostępna wersja dwuświatłowa lub dostępna końcówka zagięta kątowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także do postępowania mikrocewniki z dostępną wersją dwuświatłową a także z końcówką zagiętą kątowo.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga by końcówka cewnika pokryta była silikonem? Warstwa silikonowa w przeciwieństwie do warstwy hydrofilnej powoduje większe tarcie cewnika o naczynie a zatem trudniejsze z niego wysuwanie co jest główną ideą jego stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także cewniki z końcówką pokrytą silikonem.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga posiadania przez cewnik specjalnej rynny pozycjonującej długie stenty podczas przejścia przez kręte naczynia o długości min. 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania przez cewnik specjalnej rynny pozycjonującej długie stenty, cecha ta może wystąpić w oferowanym produkcji ale nie jest wymagana.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w Pak 26 poz. 3 wyrazi zgodę na światło cewnika aspiracyjnego większe od 0,037" a zatem o szybszym tempie aspiracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także cewniki do aspiracji o świetle większym niż 0.037". Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w Pak 26 poz. 4 wyrazi zgodę na zestaw z 2 strzykawkami po 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także cewniki do aspiracji z dwoma strzykawkami 30 lub 60 ml.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



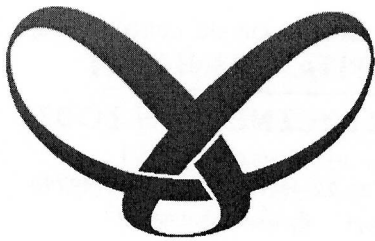

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 32 system protekcji dystalnej do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym pomostów aortalno wieńcowych do naczyń o średnicach od 3mm do 7mm, system umożliwiający zastosowanie przewodnika niezależnego 0,014'' lub 0,018'', kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także system o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 42

Do treści §1 ust. 3 oraz 4 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 3 oraz 4 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 43

Do treści §7 ust. 1 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 miesięcy od daty dostawy lub dopisanie do §7 ust.1 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie 44

dot. Pakiet 55 Wkład strzykawkowy do podawania kontrastu o pojemności 200 ml – Załącznik nr 3 do SIWZ – Parametry techniczne:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 55 wkłady w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD MARK V PROVIS o pojemności 150 ml?


Odpowiedź: Zamawiający może dopuścić opisywany w pytaniu wkład pod warunkiem dostarczenia próbki w celu sprawdzenia kompatybilności z posiadanym we wstrzykiwaczu uchwytem na wkłady. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



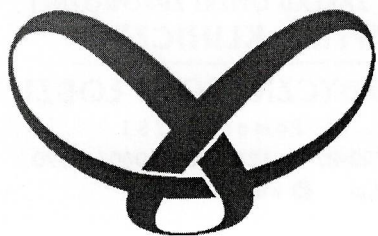

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 45


Do Zad.13

Czy Zamawiający dopuszcza profil max. szafu 2,3F dla balonów 1.2-2.5, oraz 2,5 dla 1mm przy tip profile 0,0157”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza profil max. szafu 2,3F lub 0,78mm dla balonów 1.2-2.5, oraz 2,5 dla 1mm przy tip profile 0,0157. Pozostałe wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 46, dotyczy pakietu nr 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie introducerów radialnych, z mini-prowadnikiem do wyboru: 0.018”, 0.021”, dostępna końcówka „J” oraz prosta – stalowa – zwężana na końcu w celu łatwego wprowadzenia do naczynia = dodatkowa korzyść wyboru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, igła 20G oraz 21G, ścięta pod kątem, bez wskazanego kierunku.

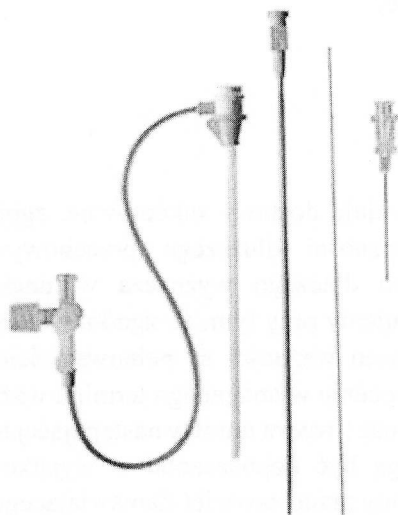

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia parametry techniczne Pakietu 1 bez zmian –zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47, dotyczy pakietu nr 2:


Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przewodników z pokryciem teflonowym o długościach do wyboru Zamawiającego: 150cm/ 180cm (WYMAGANE 190cm)/ 200cm oraz 260cm o dwóch różnych krzywiznach końcówki „J” do wyboru (1.5mm/3mm) oraz końcówce prostej - pozostałe warunki zgodne z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



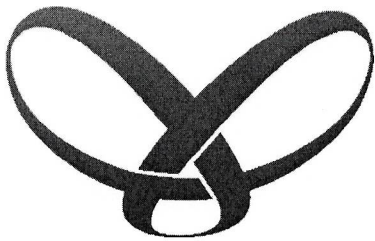

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także prowadniki o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 48, dotyczy pakietu nr 22:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw inflatora z Y-konektorem, gdzie inflator wyposażony w dren wysokociśnieniowy 1200psi zakończony kranikiem trójdrożnym czy też wymaga innych elementów składowych zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania także inflatory o opisanych w pytaniu parametrach.

Pytanie 49, dotyczy pakietu nr 27:

Prosimy o wyodrębnienie zestawu absorbującego z pakietu na inflatory i utworzenie osobnego zadania.

Odpowiedź: Parametry pakietu 27 opisane w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50

Pakiet 3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 do oceny cewników diagnostycznych o rozmiarach 4F, 5F, oraz 6F.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę także na dopuszczenie cewników o wymiarach 4-6F.

Pytanie 51

Pakiet 17. Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika balonowego uwalniającego lek o profilu przejścia 0,034" dla średnicy 3.00, ciśnieniu nominalnym 6 atm i ciśnieniu RBP 16 atm z własnymi udokumentowanymi badaniami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę także na dopuszczenie cewników balonowych uwalniających lek o podanych parametrach (profil przejścia 0,034" dla średnicy 3.00, ciśnienie nominalne 6 atm i ciśnienie RBP 16 atm) pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Uwaga:

W przypadku dopuszczenia innych parametrów niż określone w SIWZ, należy wpisać w Załączniku nr 3 (Parametry techniczne) oferowany parametr oraz dopisać, że został on dopuszczony zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



