

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 16.05.2019 r.

ZP/ 30 /2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytania 1

Część 6, Pozycja 2.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik 4,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 2

Część 6, Pozycja 4.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, szpatuła 32x85mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 3

Część 6, Pozycja 8.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł.110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 4

Część 6, Pozycja 9.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ssak 65mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 5

Część 6, Pozycja 11.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta 110mm, 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



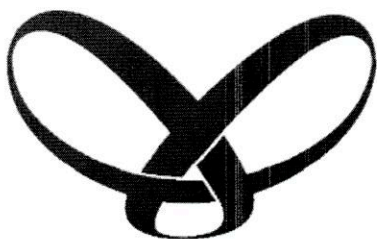

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 6

Część 45, Pozycja 1.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 7

Część 45, Pozycja 2.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 8

Część 45, Pozycja 3.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 9

Część 45, Pozycja 7.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 10

Część 45, Pozycja 8.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 11

Część 45, Pozycja 9.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 12

Część 45, Pozycja 11.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



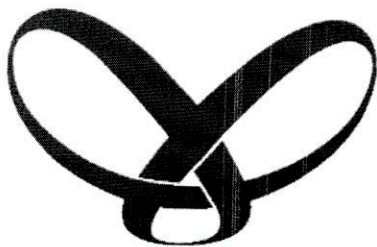

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Tak.

Pytania 13

Pakiet 41 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla EKG.

Odpowiedź:

Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue)

Pytania 14

Pakiet 41 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy kabel ma być jedno czy dwurzędowy.

Odpowiedź:

Dwurzędowy.

Pytania 15

Pakiet 41 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź:

Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue)

Pytania 16

Pakiet 41 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu monitora Philips.

Odpowiedź:

Mx700 (Intelli Vue)

Pytania 17

Pakiet 41 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu monitora Philipsa.

Odpowiedź:

Mx700 (Intelli Vue)

Pytania 18

Pakiet 41 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla o długości 2,4 metra ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 19

Pakiet 41 Pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla o długości 2,4 metra ?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



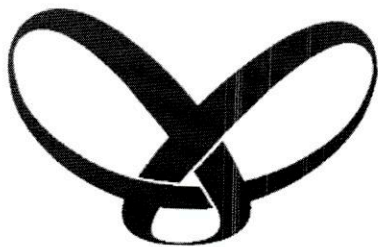

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Tak.

Pytania 20

Pakiet 47 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pulsoksymetru typu Novamatrix, Jednorazowego użytku dla dzieci o wadze 3-40 kg bezklejowy, zapinany na rzep ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 21

Pakiet 47 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pulsoksymetru typu Novamatrix - Czujnik saturacji jednorazowy dla dzieci 3-20 kg klejowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 22

Pakiet 57 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego niemowlęcego, obwód 5-11 cm ;długość 20 cm; szerokość 6 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 23

Pakiet 57 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego dziecięcy, obwód 14-21 cm ;długość 27 cm; szerokość 8 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania 24

Pakiet 57 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego pediatryczny, obwód 21-28 cm ;długość 38 cm; szerokość 11 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 25

Pakiet 57 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego dla dorosłych mały, obwód 21-28 cm ;długość 41,5 cm; szerokość 12 cm ;dwuwarstwowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 26

Pakiet 57 Pozycja 11



ul. Pomorska 251


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



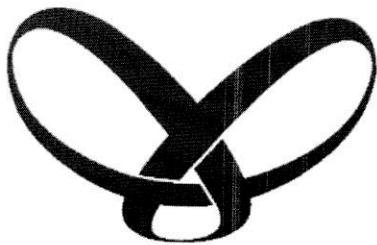

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF konektorów.

Odpowiedź:

Kompatybilny z kablem do NIBP do monitora NIHON KOHOEN MU 671 RK

Pytania 27

Pakiet 59 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania 28

Pakiet 59 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu monitora Philipsa.

Odpowiedź:

Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue)

Pytania 29

Pakiet 59 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź:

Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue)

Pytania 30

Pakiet 59 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla (1 metr, 1,5 metra czy 3 metry)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga długości kabla 150cm i 300 cm.

Pytania 31

Pakiet 59 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź:

Kompatybilny z czujnikiem Nellcor.

Pytania 32

Pakiet 59 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla (1 metr, 1,5 metra czy 3 metry)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga czujnika bez kabla.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



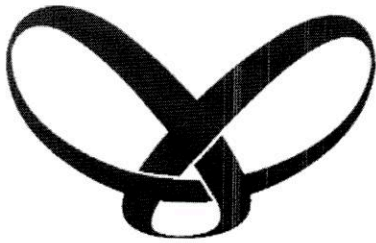

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 33

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 34

Dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający wymaga aby filtry przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zabezpieczające układ oddechowy w respiratorze podczas podawania leków przy nebulizacji nie traciły swojej skuteczności do 48 godzin bez konieczności wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytania 35

Dotyczy pakietu nr 48

Przy stosowaniu standardowych filtrów zaleceniem producenta jest, aby były one wymieniane po każdorazowym podaniu leku przez nebulizator.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 36

Dotyczy pakietu nr 53

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka (powikłanie hipotetyczne, oparte na wynikach badań). Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 37

Dotyczy pakietu nr 53

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: Micro – poniżej 28 cm, Small – 28 cm - 34 cm, Large – powyżej 34 cm? Okulary posiadają zapięcie na rzepy do regulacji zgodnie z wytycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 38

Dotyczy pakietu nr 66

Prosimy o odstąpienie od wymogu dla układu oddechowego z komorą nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



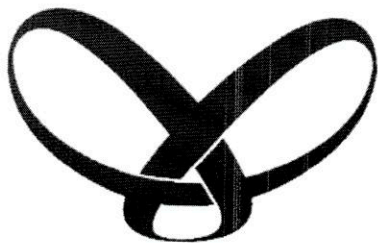

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytania 39

Dotyczy pakietu nr 83

Prosimy w pakiecie nr 83 o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia. Opisanie przedmiotu zamówienia wyposażonego w dwa pływaki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytania 40

Pakiet 92- Dostawa żelu do usg - na potrzeby bloku anestezyjologicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie sterylne zestawy osłon na głowice USG o następujących cechach:

- nie wymagające żelu do USG podczas badania, minimalizując ryzyko zakażenia oraz zanieczyszczenia próbek pobieranych materiałów biologicznych żelem ultrasonograficznym.
- posiadające czoło 3D, które nie zakłóca obrazu podczas badania
- nie wytwarzane z naturalnego lateksu
- składane teleskopowo
- rozmiar 14 x 147cm
- przetestowane zgodnie z protokołem ASTM F1671 potwierdzającym skuteczność ochrony przed wirusami o wielkości 27nm i większych
- 2 elastyczne opaski w zestawie
- Sterylna serweta 30x30cm w zestawie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 41

Dotyczy Pakietu nr 74 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, kształt okrągły, dla pacjenta o masie 3-8 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH₂O przy Vt=50 ml, waga 9 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów, umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia oraz m.in. poprzednich postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Państwa Placówkę- sprawa ZP/62/2017 oraz ZP/18/2018 – jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta) co powoduje, że wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytania 42

Dotyczy Pakietu nr 74 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, kształt okrągły, skuteczności nawilżania 32 mg H₂O przy V_t=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów, umożliwiła złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia oraz m.in. poprzednich postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Państwa Placówkę- sprawa ZP/62/2017 oraz ZP/18/2018 – jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta) co powoduje, że wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytania 43

Dotyczy Pakietu nr 74 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, kształt okrągły, dla objętości oddechowej 150-1500 ml przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów, umożliwiła złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia oraz m.in. poprzednich postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Państwa Placówkę- sprawa ZP/62/2017 oraz ZP/18/2018 – jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta) co powoduje, że wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 44

Dotyczy Pakietu nr 74 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



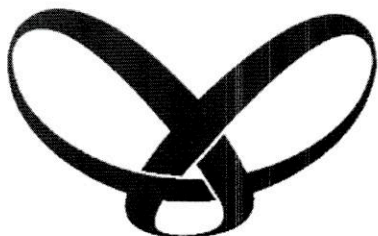

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów, umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia oraz m.in. poprzednich postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Państwa Placówkę- sprawa ZP/62/2017 oraz ZP/18/2018 – jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta) co powoduje, że wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytania 45

Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 46

Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 2.4m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 47

Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 4

Prosimy o podanie modelu aparatu z jakim mają być kompatybilne czujniki. Obecny opis jest nieprecyzyjny

Odpowiedź:

Do monitora MX500 i monitora M X 700 Intelli Vue.

Pytania 48

Dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1-3

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania 49

Dotyczy pakietu 97 pozycja 1

Ze względu na wycofanie z obrotu przez producenta filtrów antybakteryjnych wielokrotnego użytku do aparatu do znieczulenia Primus prosimy o dopuszczenie filtrów antybakteryjnych jednorazowego użytku, kompatybilnych z aparatem do znieczulenia Primus.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 50

Dotyczy pakietu 97 pozycja 4



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



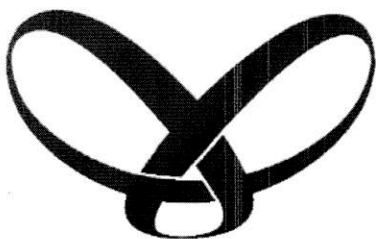

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Ze względu na opakowania zbiorcze dostarczane przez producenta prosimy o dopuszczenie linii do kapnografii do aparatu do znieczulenia PRIMUS pakowane w niepodzielne opakowania zbiorcze zawierające po 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 6 opakowań = 60 sztuk czy 60 opakowań = 600 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 51

Dotyczy pakietu 103 pozycja 4

Ze względu na opakowania zbiorcze dostarczane przez producenta prosimy o dopuszczenie linii do kapnografii do aparatu do znieczulenia PRIMUS pakowane w niepodzielne opakowania zbiorcze zawierające po 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 4 opakowań = 40 sztuk czy 40 opakowań = 400 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 52

Dotyczy pakietu 79

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby rurki wykonane były z mieszaniny silikonu i PCW co ma znaczący wpływ na twardość rurki co ma szczególne znaczenie przy ich stosowaniu do intubacji wcześniaków i noworodków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 53

Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 54

Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający w ramach zapisu „d) dotyczy Pakietu Nr: 2, 6 ; 7 ; 45 ; 91 ;105 - karta technologiczna mycia, konserwacji i sterylizacji oraz instrukcja mycia maszynowego i dezynfekcji termicznej”, dopuści instrukcję w której zawarte są wszystkie niezbędne informacje o reprocessing w tym myciu, sterylizacji, dezynfekcji i konserwacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 55

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 64 maski w pozycji 1 oraz 2 – maskę krtaniową jednorazowego użytku gdzie rozmiar „objętość wypełnienia mankieta jest na grzbiecie maski oraz opakowaniu a nie na baloniku kontrolnym pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



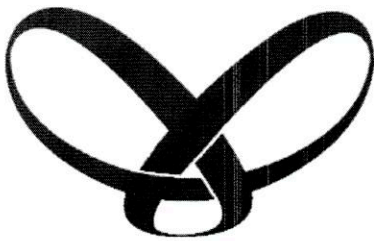

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 56

Czy Zamawiający w pak 67 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy znanego amerykańskiego producenta, trzykomorowy, pracujący bezgłośnie, częściowo przezroczysty, komora zbiorcza o pojemności 2500 ml, zastawka wodna (możliwość zastosowania u pacjentów pediatrycznych), automatyczny zawór ciśnienia dodatniego, port ciśnienia ujemnego, port wahadłowy umożliwiający regulację siły ssania, przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze. Pakowany podwójnie (papier-folia)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 57

Czy ze względu na zaprzestanie produkcji łącznika V-link Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 77 w punkcie 1 linii przedłużającej typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi oraz z zastawkami zapobiegającymi cofaniu się płynu do łącznika, o łącznej długości 15cm i objętości wypełnienia 0,85ml. Łącznik na stałe połączony z linią przedłużającą. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 58

Czy ze względu na zaprzestanie produkcji łącznika V-link Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 77 w punkcie 2 lini przedłużającej typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi Onelink, o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojęte z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem męskim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 59

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 67 drenażu o poniższych parametrach:

- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekccyjnej do pobierania próbek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



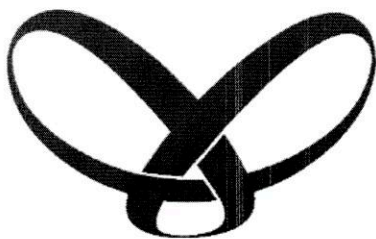

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku
- możliwość zastosowania u pacjentów pediatrycznych.

Proponowany zestaw jest dostarczany do Zamawiającego w ramach zawartej umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 60

Załącznik nr.5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytania 61

Pakiet 8, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 62

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer posiadającą przezroczysty ergonomiczny uchwyt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 63

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer w rozmiarze CH 21 (3,9/7,0), drenem CH 24 o dł. 400cm z doklejanymi standardowymi końcówkami żeńskimi, bez możliwości docięcia do odpowiedniego typu ssaka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania 64

Pakiet 17, pozycja 2



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”



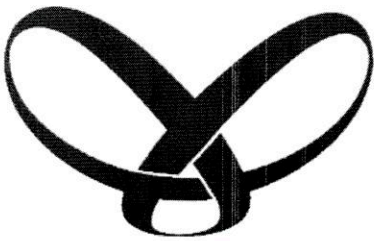

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści zestaw mini do drenażu ran ciała z harmonijkowym mieszkiem o pojemności 25ml lub 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania 65

Pakiet 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu ran ciała z harmonijkowym mieszkiem o pojemności 250ml oraz 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytania 66

Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści harmonijkowe mieszki o pojemności 250ml oraz 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytania 67

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów mat +/- 0,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 68

Pakiet 19, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowy licznik igieł z ponumerowaną do 20 pianką do liczenia igieł?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 69

Pakiet 61, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę przyssawkową o średnicy 1,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 70

Pakiet 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez mankieta, dostępne w rozmiarach od 3,5 do 6,0 (co 0,5)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 71



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



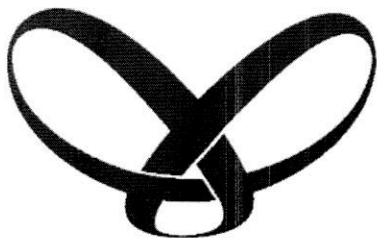

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łódzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pakiet 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem, dostępne w rozmiarach od 5,0 do 10,0 (co 0,5)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 72

Pakiet 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z trzema oznaczeniami rozmiaru: na korpusie, baloniku kontrolnym oraz na łączniku 15mm, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch równoległych znaczników na ok. 1/6 obwodu rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytania 73

Pakiet 76, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści zbrojone rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch równoległych znaczników na ok. 1/6 obwodu rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytania 74

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1.1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 75

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:

- a) Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3 % wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru;**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3 % wartości **brutto** nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

wymianę o którym mowa w § 5. ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 76

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu poz. 1 cewniki silikonowe Broviac z miękkiego silikonu odpornego na leki zawierające Jod. Cewnik z zestawem do wprowadzania przeszłernego. Rozmiar 4,2 Fr, długość cewnika 71 cm, śr. wewn 0,7 mm. Końcówka Luer Lock wykonana z materiału Derlin ograniczającym efekt tzw. zapiecenia. Cewnik wzmocniony w miejscu zacisku celem ograniczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika. Oznaczenie miejsca zacisku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 77

Pakiet 70

Poz. 2. Cewnik tunelizowany Broviac z miękkiego silikonu odpornego na leki zawierające Jod. Cewnik z zestawem do wprowadzania przeszłernego. Rozmiar 6,6 Fr, długość cewnika 90 cm, śr. wewn 1 mm. Końcówka Luer Lock wykonana z materiału Derlin ograniczającym efekt tzw. zapiecenia. Cewnik wzmocniony w miejscu zacisku celem ograniczenia zmniejszenia światła na skutek długotrwałego zamknięcia cewnika. Oznaczenie miejsca zacisku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 78

Prosimy również o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz 1, 2 oraz 7 z pakietu 70 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytania 79

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści kabel do EKG końcowy czy kabel EKG odprowadzeniowy, zakończony kłamarą o długości 90cm - (3-odprowadzeniowy) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitor MX500 MX700 Intelli Vue

Pytania 80

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz.2



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



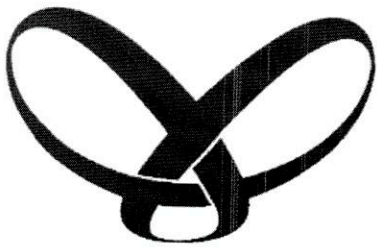

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści kabel do EKG końcowy czy kabel EKG odprowadzeniowy, zakończony zatrzaskiem o długości 90cm - (3-odprowadzeniowy) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania 81

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz.3

Czy zamawiający dopuszcza długość czujnika 1,1 m? Czy wtyczka od czujnika ma być w technologii Nellcor czy jest to wejście typu Philips (8pin;półokrągłe)?

Odpowiedź:

Kompatybilne z Philips MONITOR MX500 MX700 Intelli Vue

Pytania 82

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza długość czujnika 1,1 m? Czy zamawiający dopuszcza zakres wagowy czujnika 15-40kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 83

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz.5

Czy zamawiający dopuszcza długość czujnika 1,1m? Czy zamawiający dopuszcza zakres wagowy czujnika 1-3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 84

Pakiet 41-Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP

Poz. 6

Czy zamawiający dopuszcza długość kabla połączeniowego SPO2 - 2,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 85

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skalpela bezpiecznego, jednorazowego, z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, bez przezroczystej osłony co umożliwia stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel wyposażony w przycisk płynnie działający, umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel posiada blokadę pozwalającą na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej jest trwała, uniemożliwia ponowne użycie. Obudowa skalpela wyposażona w miarkę w cm od 1 do 5. Pakowane po 25szt. Seria i data ważności wydrukowana na każdej sztuce.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



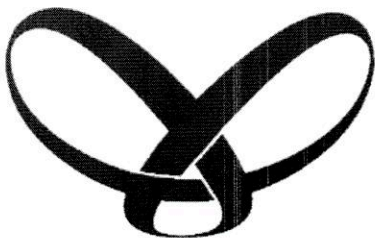

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Pytania 86

Pakiet 49:

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowanego produktu o następujących cechach:

Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 87

Pakiet 50:

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medyczne stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) mają być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 88

Pakiet 56: Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania produktu o następujących parametrach:

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 89

Pakiet 56: Poz.2:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



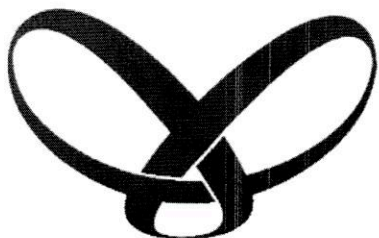

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDŹI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 90

Pakiet 56: Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 91

Pakiet 56: Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



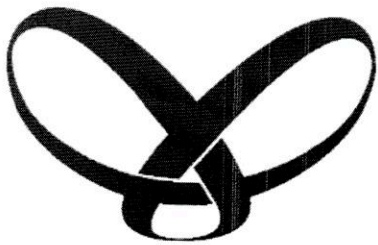

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 92

Pakiet 56: Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Rampy pięciokranikowej do kompleksowej intensywnej opieki ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia dodatkowych linii infuzyjnych. Wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej., Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty., Rampa z zaworami bezigłowymi typu SWAN z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, Przezroczysty , elastyczny, odporny na zagięcia dren z PCV z TOTM (bez zawartości DEHP),

Długość 150 cm, z zastawkami typu Flow Stop, z zintegrowaną hydrofobową membraną, pozwala na utrzymanie sterylności zestawu i bezpieczne wypełnienie linii. Męski łącznik Luer-Lock z obrotowym kołnierzem zapewnia bezpieczne i łatwe połączenie.

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Rampa trójkranikowej do kompleksowej intensywnej opieki ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej, Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, Rampa z zaworami bezigłowymi typu SWAN z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, Przezroczysty , elastyczny, odporny na zagięcia dren z PCV z TOTM (bez zawartości DEHP),

Długość 150 cm, z zastawkami typu Flow Stop, z zintegrowaną hydrofobową membraną, pozwala na utrzymanie sterylności zestawu i bezpieczne wypełnienie linii, Męski łącznik Luer-Lock z obrotowym kołnierzem zapewnia bezpieczne i łatwe połączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 93

Pakiet 68: Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach:

Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 94

Pakiet 68 Poz.2:


Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach:



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



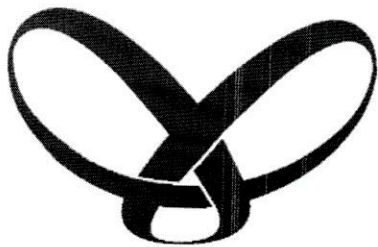

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 1L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 95

Pakiet 12

Poz. 1, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 96

Pakiet 12 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 97

Pakiet 33 Poz. 1, 2, 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 i 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 98

Pakiet 33 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie powierzchni aktywnej 32cm² i całkowitej 66cm²

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 99

Pakiet 33 Poz. 6, 7, 8 i 14

Prosimy o wydzielenie pozycji 6, 7, 8 i 14 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



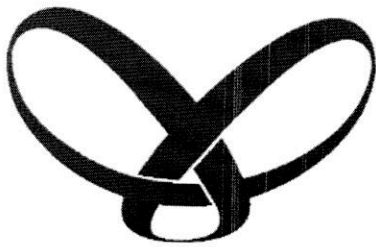

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 100

Pakiet 33 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 18 cm lub 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pincety o długości 18 cm.

Pytania 101

Pakiet 40 Poz. 1, 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie czujników z jedną opaską (bez stabilizatora na kostkę)

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej oraz funkcji raportu z pracy i funkcji komunikatów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 102

Pakiet 40 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze <3kg,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 103

Pakiet 40 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze 1-15kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 104

Pakiet 40

Poz. 5, 6

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 i 6 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej oraz funkcji raportu z pracy i funkcji komunikatów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 105

Pakiet 41 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 0,95m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 106



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



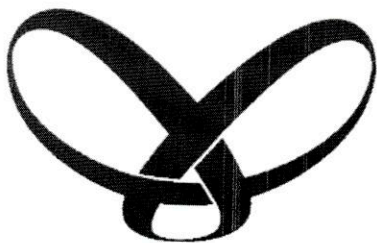

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pakiet 41 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 3 do 15 kg z kablem o długości 1 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 107

Pakiet 41 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 10 do 40 kg z kablem o długości 1 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 108

Pakiet 41 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości 1 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 109

Pakiet 41 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 110

Pakiet 41 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 111

Pakiet 47 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 3kg-40kg lub <3kg i >30 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia cząstkowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 112

Pakiet 47 Poz. 3

Prosimy dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 1kg-20kg

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”



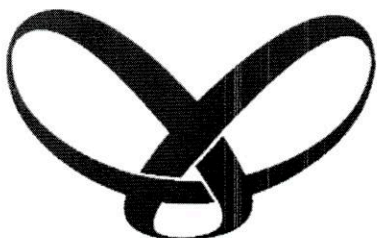

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 113

Pakiet 47 Poz.4

Prosimy o dopuszczenie adaptera o długości 2,5m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 114

Pakiet 54 Poz. 7

Prosimy o wydzielenie poz. 7 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z poliacetalu, mikrobiologicznie czystych, jednorazowego użytku, kompatybilnych z tzw. „zielonym standardem” (ISO 7376), pakowanych folia-folia

Prosimy o dopuszczenie łyżek w rozmiarach: 1, 2, 3, 4

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 115

Pakiet 54 Poz. 10, 11, 12, 13, 14

Prosimy o wydzielenie poz. 10-14 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Prosimy o dopuszczenie kołderek grzewczych, jednopacjentowych, wykonanych z mocnego materiału dwuwarstwowego: PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen), bez funkcji dodatkowego filtrowania powietrza, przenikalnych dla promieniowania RTG, bezłateksowych, 2-kolorowych, unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalneprzenikanie powietrza, kompatybilnych z ogrzewaczami WarmAir

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 116

Pakiet 54

Poz. 10, 14

Prosimy o dopuszczenie kołderki grzewczej pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach: 217 x 91 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 117



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pakiet 54 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie kołderki grzewczej pediatrycznej / na dolną część ciała o wymiarach: 120 x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 118

Pakiet 54 Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie kołderki grzewczej na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach: 195 x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 119

Pakiet 57 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. 21 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 120

Pakiet 57 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szer. 8.8 cm i dł. 21 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 121

Pakiet 57 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szer. 11.5 cm i dł. 39 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 122

Pakiet 57 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozm. 21-27 cm szer. 11.5 cm i dł. 39,5 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 123

Pakiet 57 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie szer. 14.5 cm i dł. 50 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 124

Pakiet 57 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie szer. 14.5 cm i dł. 69 cm



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



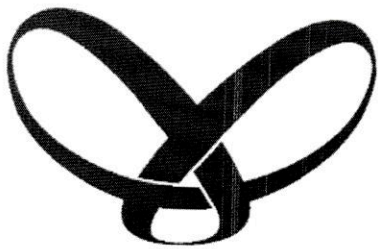

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 125

Pakiet 57 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozm. 35-44 cm szer. 17.5 cm i dł. 55 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 126

Pakiet 57 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie rozm. 34-47 cm szer. 17.5 cm i dł. 65 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 127

Pakiet 57

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie szer. 22 cm i dł. 78 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 128

Pakiet 59

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. 1 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 129

Pakiet 59

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 130

Pakiet 59

Poz. 3 i 4

Prosimy o podanie czy czujniki mają być wpinane do kabla z poz. 2 czy bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź:

Tak. Wpinane do kabla z poz. 2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania 131

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji nr 9 dopuści:



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”



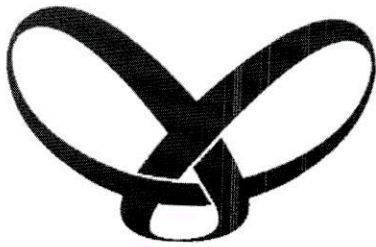

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Ssak uszny z kontrolą ssania w uchwycie, zagięty typu Luer dł. 100mm, śr. ssaka 1,0 mm, 1,4 mm, 1,7 mm, 2,0 mm w zależności od zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 132

Czy Zamawiający w pakiecie nr 105 w pozycji nr 1 dopuści:

ssak uszny typu Frazier z mandrynem, kontrola ssania kąt nachylenia 90°, dł. 110 mm, śr. ssaka 2,3 mm, 2,7 mm; średnica 3,4 mm: zamawiający złoży zamówienie w zależności od zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 133

Czy Zamawiający w pakiecie nr 105

watotrzymacz typu Farell uszno - nosowy skrętny z uchwytem dł. 110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 134

czy Zamawiający w pakiecie nr 105

watotrzymacz typu Buck uszno - nosowy skrętny z uchwytem dł. 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 135

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skalpela bezpiecznego, jednorazowego, z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, bez przezroczystej osłony co umożliwi stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel wyposażony w przycisk płynnie działający, umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel posiada blokadę pozwalającą na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej jest trwała, uniemożliwia ponowne użycie. Obudowa skalpela wyposażona w miarkę w cm od 1 do 5. Pakowane po 25szt. Seria i data ważności wydrukowana na każdej sztuce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 136

Pakiet 49:

Prosimy o dopuszczenie zaferowani produktu o następujących cechach:

Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



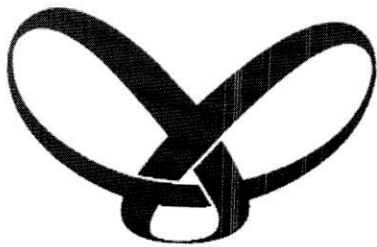

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytania 137

Pakiet 50:

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medycznymi stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) mają być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 138

Pakiet 56 Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach:

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 139

Pakiet 56 Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wewnątrz pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



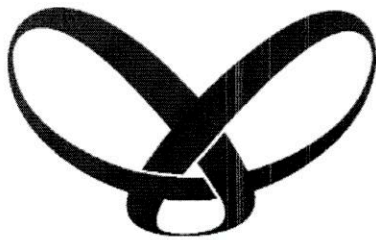

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 140

Pakiet 56 Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatraskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałow powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 141

Pakiet 56 Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałow powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 142

Pakiet 56 Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Rampy pięciokranikowej do kompleksowej intensywnej opieki ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia dodatkowych linii infuzyjnych. Wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej., Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty., Rampa z zaworami bezigłowymi typu SWAN z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, Przezroczysty, elastyczny, odporny na zagięcia dren z PCV z TOTM (bez zawartości DEHP),



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



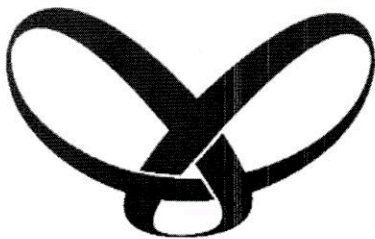

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Długość 150 cm, z zastawkami typu Flow Stop, z zintegrowaną hydrofobową membraną, pozwala na utrzymanie sterylności zestawu i bezpieczne wypełnienie linii. Męski łącznik Luer-Lock z obrotowym kołnierzem zapewnia bezpieczne i łatwe połączenie.

Prosimy o dopuszczenie zaferowania Rampa trójkranikowej do kompleksowej intensywnej opieki ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej, Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, Rampa z zaworami bezigłowymi typu SWAN z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, Przezroczysty, elastyczny, odporny na zagięcia dren z PCV z TOTM (bez zawartości DEHP),

Długość 150 cm, z zastawkami typu Flow Stop, z zintegrowaną hydrofobową membraną, pozwala na utrzymanie sterylności zestawu i bezpieczne wypełnienie linii, Męski łącznik Luer-Lock z obrotowym kołnierzem zapewnia bezpieczne i łatwe połączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 143

Pakiet 68 Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach:

Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 144

Pakiet 68 Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktu o następujących parametrach:

Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 1L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 145

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1, 2, 3 i 4 Pakietu 28 i zaferowanie worków z wypychaczem o długości minimum 200 mm o parametrach:

- w pozycji 1 worka o szerokości 85 mm i głębokości 185 mm
- w pozycji 2 worka o szerokości 110 mm i głębokości 210 mm



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



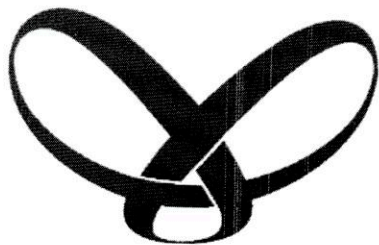

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- w pozycji 3 worka o szerokości 160 mm i głębokości 200 mm
- w pozycji 4 worka o szerokości 200 mm i głębokości 260 mm do trokara 12

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 146

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 9 do 13 pakietu 28.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 147

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 148

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaferowanie klipsonic o długości ramienia klipsa minimum 10 mm i szerokości rozwarcia klipsa 11 – 12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 149

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaferowanie klipsownic o długości ramienia minimum 7,5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Długość ramienia maksymalnie 7,5 mm.

Pytania 150

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaferowanie siatki bez folii, średnica siatki 30 mm, średnica osłony 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 151

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaferowanie siatki bez folii, średnica siatki 40 mm, średnica osłony 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 152


Pakiet nr 106



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”



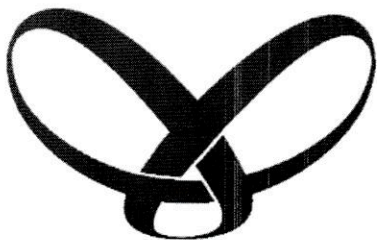

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w pozycji 10, 11 i 13 dopuści zaoferowanie pętli o grubości drutu 0,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Pętla 0,4 mm wyszczególniono w poz.12.

Pytania 153

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 12 i 14 dopuści zaoferowanie pętli o grubości drutu 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 154

Pakiet nr 106

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 155

Pakiet 107

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości narzędzia 2400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 156

Pakiet nr 87

Czy Zamawiający w pakiecie 87 dopuści pozycji 1 silikonowy cewnik typu Broviak 3,0Fr bez zestawu wprowadzającego i w pozycji 2 cewnik w rozmiarze 4,2 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Pytania 157

Pakiet 47- Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novamatrix

Poz.2

Czy zamawiający dopuszcza zakres wagowy do 3 kg oraz powyżej 30kg lub zakres wagowy 3-20kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 3-20 kg oraz powyżej 30kg.

Pytania 158

Pakiet 47- Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novamatrix

Poz.3

Czy zamawiający dopuszcza zakres wagowy do 3 kg oraz powyżej 30kg lub zakres wagowy 3-20kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do 3 kg oraz 3-20 kg.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



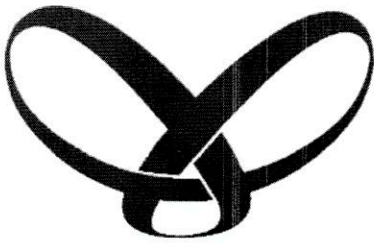

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytania 159

Pakiet 59- Dostawa czujników do Philips

Poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza zapis "czujnik spo2 dla dorosłych (+40kg) typu klips na ucho typu Philips"?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

Sekretarz

Komisji Przetargowej


mgr Agnieszka Dominczyk



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

